promedics®
an Aspen company

AWR - Pneimatiskā staigāšanas ortoze

LV POTĪTES UN PĒDAS ORTOZE

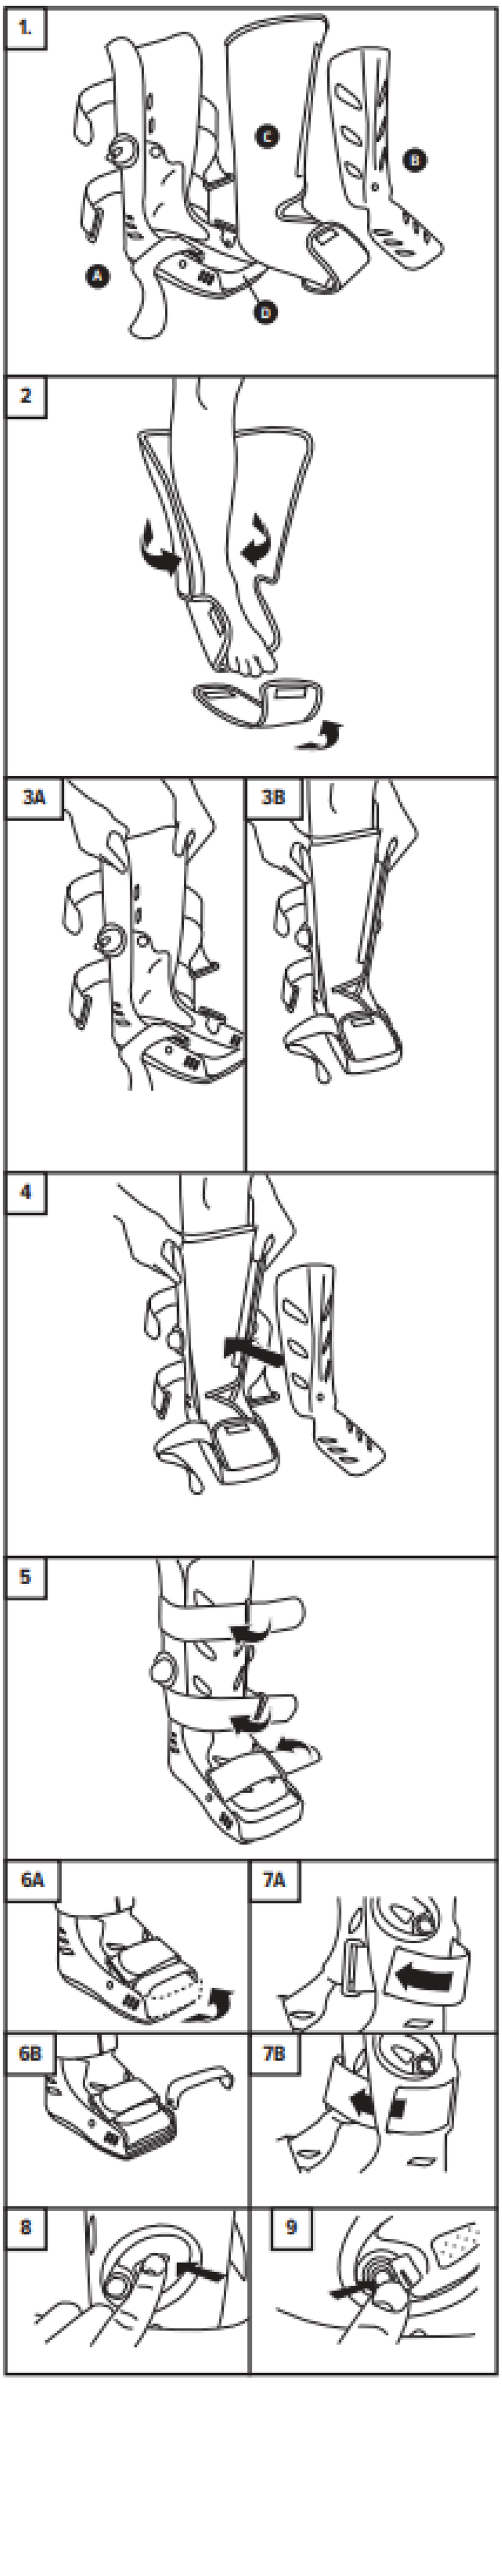

MD MEDICĪNISKA IERĪCE

1 VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI

UZMANĪBU

Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Garoloch Road, Port Glasgow, Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk

CE EC REP **EMERGO EUROPE**
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

©2023 Promedics Orthopaedics Ltd. All Rights Reserved.

AWRIFUC revised 4/23

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts
Staigāšanas ortoze ar pilnībā integrētu piepūšanas sistēmu, kas ļauj veikt neatkarīgu regulēšanu.

Lietošana (skatiet attēlus)
1. Uzliekot ortozi pirmo reizi, atveriet visas siksnas (A), noņemiet priekšējo apvalku (B) un pēc tam izņemiet iekšējo oderi (C). Pirkstu aizsargu (D) var regulēt vai noņemt (skatiet tālāk 7. soli).
2. Uzvelciet iekšējo oderi, pārliecinoties, ka papēdis ir pilnībā ievietots tajā. Aizveriet līplentes aizdares pēdas un apakšstilba daļā, nodrošinot ciešu piegulšanu.
3a. Ievietojiet pēdu ar oderi ortozē tā, lai papēdis piegulētu ortozes aizmugurējai malai. 3b. Piespiediet oderi, lai to piestiprinātu pie apvalka.
4. Ar līplentes stiprinājumiem piestipriniet priekšējo plastmasas apvalku pie oderes priekšpuses.
5. Aizveriet siksnas, sākot no pirkstiem uz augšu. Tām jābūt stingri pievilktām, taču ne pārāk ciešām.
6a un 6b. Ja nepieciešams, pirkstu aizsargu var regulēt vai noņemt.
7a un 7b. Ja nepieciešams, palieliniet kompresiju uz priekšējo apvalku, izverot abus potītes siksnas galus caur ortozes atverēm, kā parādīts attēlā.
8. Spiediet pumpjus, lai piepūstu gaisa kameras līdz vajadzīgajam līmenim. Komfortu novērtējiet pēc pacienta teiktā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu spiedienu, abus pumpjus var spiest vienlaikus.
9. Atveriet vāciņu un nospiediet vārstu, lai izlaistu gaisu.

Lietošanas indikācijas
• Pēdas un potītes saslimšanas, kuru gadījumā nepieciešama kustību ierobežošana.
• Stabili pēdas lūzumi.
• Cīpslu vai saišu sastiepumi.
• Pēcoperācijas un rehabilitācijas periods.
• Apakšējo ekstremitāšu mīksto audu traumas.

Kontrindikācijas
• Nav piemērota nestabiliem lūzumiem vai lielā vai mazā lielakaula augšējās daļas lūzumiem.
• Nelieciet izstrādājumu tiešā saskarē ar bojātu ādu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.
• Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
• Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
• Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
• Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
• Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
• Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
• Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana
1. Izņemiet oderi no ortozes.
2. Mazgājiet oderi ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Neizgrieziet un nežāvējiet veļas žāvētājā. Atstājiet izklātu, lai tā izžūst gaisā.
4. Noslaukiet apvalku ar tīru, mitru drānu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ļaujiet nožūt gaisā.

Izstrādājumu saimes materiālu sastāvs
ABS, EVA, stikla šķiedra, neilons, poliamīds, poliesteris, polipropilēns, POM, tērauds, TPR, TPU.

Uzglabāšana un transportēšana
Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija
Iepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums
Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.